

Anschlussstabelle:

J= +24 V DC

K= Schaltein- /ausgang 1

D= Stromausgang 1

M= GND

Schirm an Gehäuse
ganzflächig aufgelegt

Hinweis:

Die Ein- bzw. Ausgänge
beziehen sich alle
auf GND (Pin M).

Der beim PZ verwendete I_{A-}
ist nicht mehr vorhanden.
Die Versorgungsspannung ist
nicht mehr galvanisch
getrennt !

Connecting plan :

J= +24 V DC

K= Digitalin- / output 1

D= Analogue output 1



M= GND

The cable shielding is
completley attached to
the plug housing

*All inputs and outputs use
GND (terminal M) as
reference potential.*

*The current loop pin
"Iout-" (terminal L)
previously used by PZ no
longer exists.*

*The supply voltage is no
longer galvanically
isolated!*

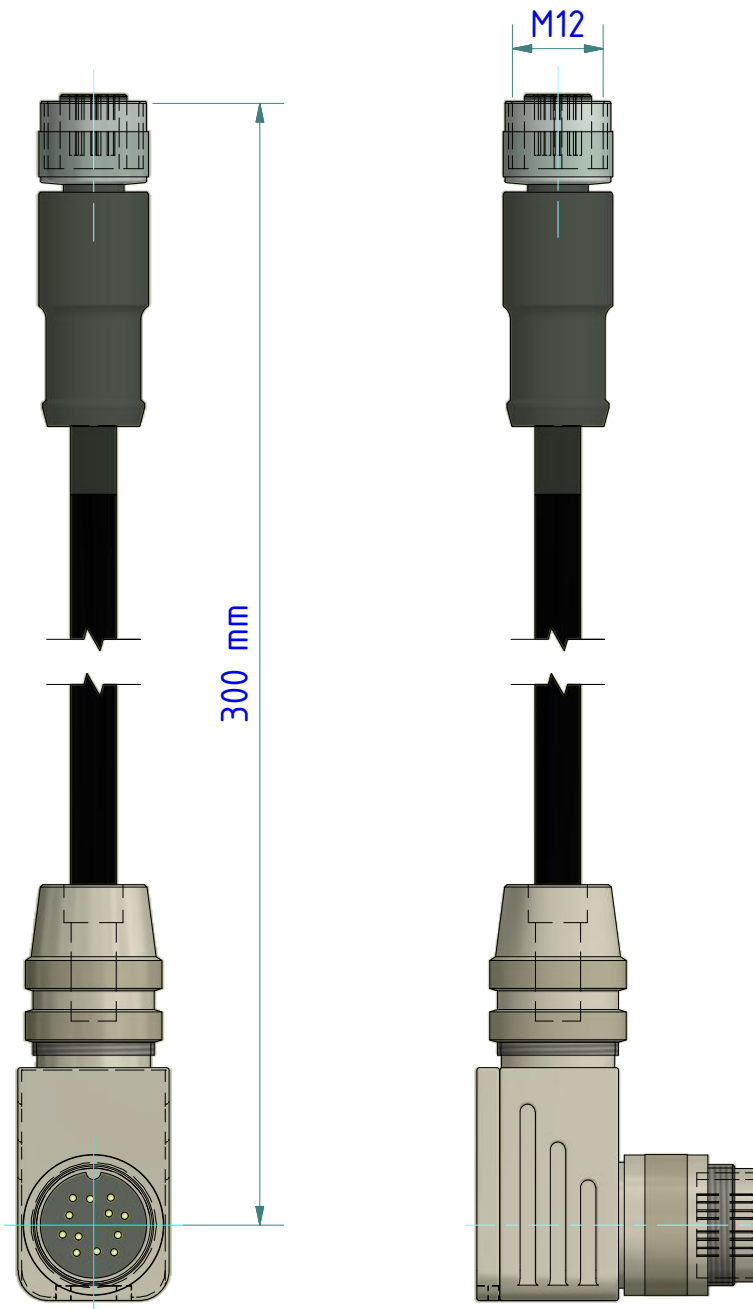

Gewicht: 0.100 Kg

Weight: 0.100 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi